




Auseinandernehmen eines TPP-Zentrifugengestelles

Mounting / demounting a TPP tube rack

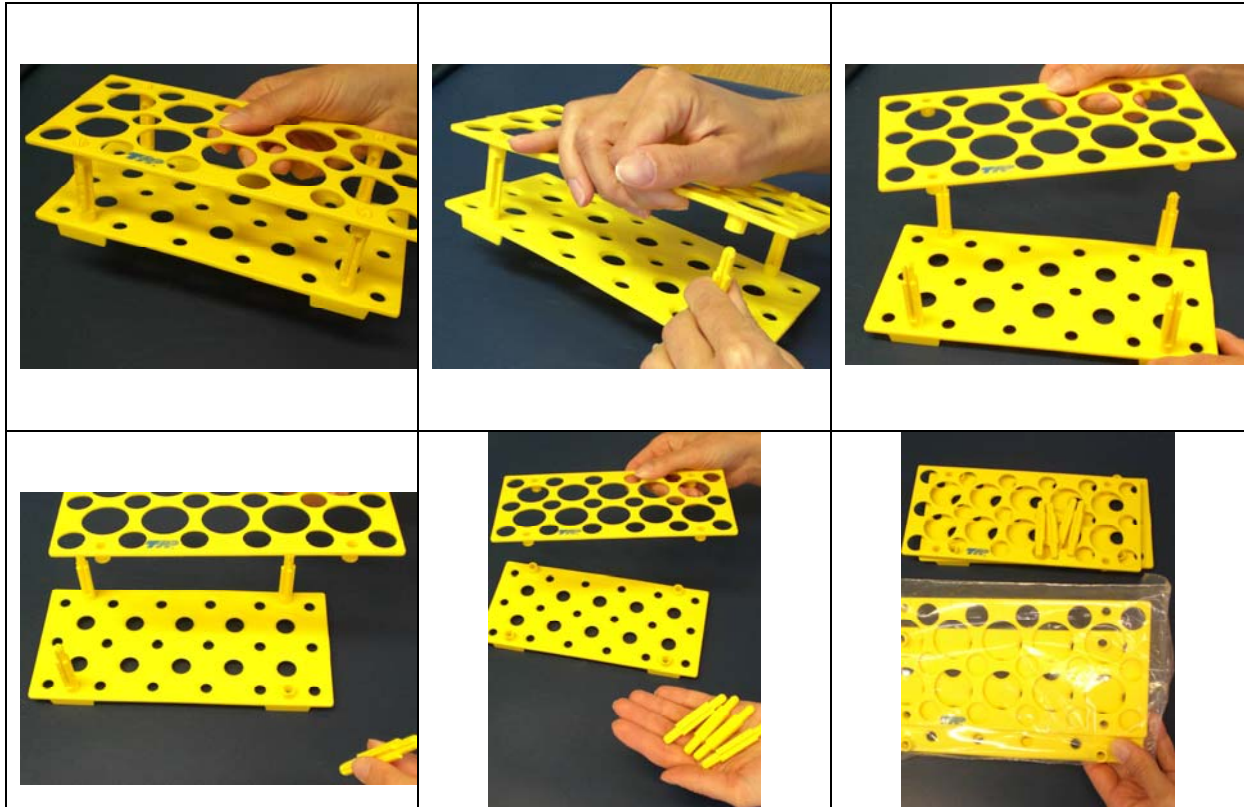

Wichtige Sterilisierungsinstruktion

Bitte nur demontiert sterilisieren

Sterilizing instructions:

Please sterilize demounted only